

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ДЯТВАК А.А.

подпись _____ инициалы, фамилия _____

01 АПР 2019

Приложение
к аттестату аккредитации

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ _____
от " _____ " _____ 20 _____ г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
(ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя


629759, Ямало-Немецкий автономный округ, Надымский район,
Юрхаровское месторождение, опорная база промысла

адрес места осуществления деятельности


Проверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ				
1	Уровнемеры и измерители уровня, датчики уровня	(0,05 – 20) м	ПГ ±(0,25 – 5) % ПГ ±(3 – 20) мм	
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ				
2	Манометры показывающие, электроконтактные, сигнализирующие, дифманометры	[(-0,1) – 60] МПа	КТ (0,15 – 4)	
3	Вакуумметры, мановакуумметры,	[(-0,1) – 60] МПа	КТ (0,15 – 4)	
4	Датчики давления, преобразователи давления, преобразователи перепада давления измерительные	[(-0,1) – 60] МПа (0 – 24) мА	КТ (0,1 – 2,5) ПГ ±(0,075 – 5) %	



Эксперт по аккредитации

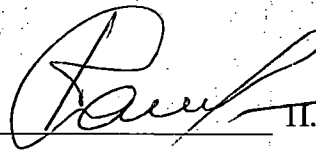 П.А. Самойлов

Технический эксперт

 Р.М. Галимарданов

Прошнуровано, пронумеровано
Всего *2* (Dba) листа
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

