



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

ОТ «16» декабря 2019 г.

№ 40-589

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лицRA.RU.312847**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ****Общество с ограниченной ответственностью «Криогаз-Высоцк»****(ООО «Криогаз-Высоцк»)**

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

**188909, Ленинградская область, Выборгский район, МО «Высоцкое городское поселение»,
Высоцкая территория, Кислицинский проезд, д. 3, строение 45**

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		При меча ние
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ				
1	Манометры, электроконтактные манометры, дифманометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры показывающие и самопишущие (в т.ч. с условными шкалами)	(-0,1...60) МПа	КТ (0,25...4,0)	
2	Датчики, преобразователи давления измерительные	(-0,1...12) МПа	ПГ ± (0,04...2,5) %	
ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ				
3	Газоанализаторы, сигнализаторы, анализаторы-течеискатели	(0...100) % об.д. (0...200) мг/м ³ (0...2000) млн ⁻¹	ПГ ± (0,04...25) % об.д. ПГ ± (5...50) мг/м ³ ПГ ± (8...810) млн ⁻¹	
4	Хроматографы газовые промышленные	(0...99,97) %	СКО (1,0...20) % по площади пика ПГ ± (0,5...40) %	

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10


10/10/10

10/10/10

1	2	3	4	5
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ				
5	Термометры показывающие, биметаллические, электроконтактные, манометрические	(-40...300) °C	ПГ ± (0,15...10) °C	
6	Термопреобразователи сопротивления, термометры сопротивления	(-50...850) °C (0...20) mA (0...10) В	КД А; В; С; ПГ ± (0,1...1) % ПГ ± (0,1...1) %	
7	Преобразователи с унифицированным выходным сигналом	(-200...1600) °C (0...20) mA (0...10) В	ПГ ± (0,1...1,5) %	
ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ				
8	Комплексы измерительные	(-10...10) В (4...20) mA (0...2000) Ом (0,1...50000) Гц	ПГ ± 0,1 % ПГ ± 0,1 % ПГ ± 0,25 Ом ПГ ± 0,1%	

Генеральный директор
ООО «Криогаз-Высоцк»


Должность уполномоченного лица

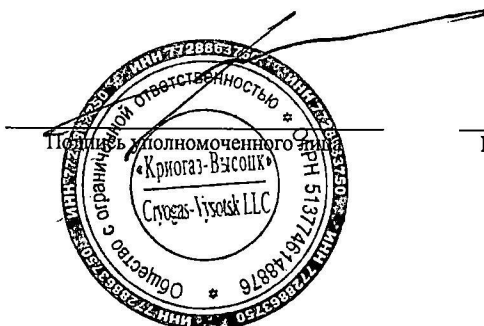

Д.В. Анищенко

Инициалы, фамилия уполномоченного


ШУКОВА А.Р.

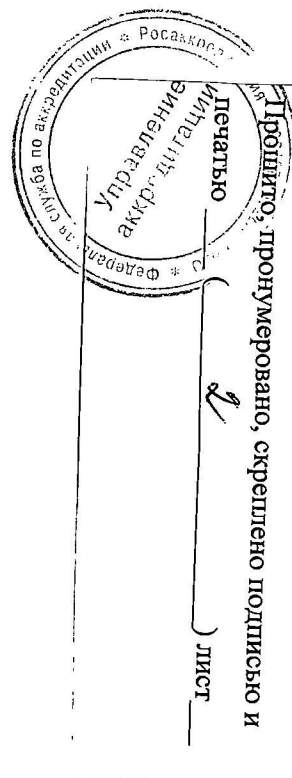

Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

Технический эксперт

Технический эксперт



Т. Ю. Шиянова



И.И. Рыбачев



В.В. Гузий



Г.Р. Хуснутдинова