


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.



Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от «__» _____ 201__ г.
на 8 листах, лист 1

Область аккредитации

Химико-бактериологической лаборатории Черноисточинского гидроузла
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал – НГ»
622940, Свердловская область, Пригородный район, п. Черноисточинск, ул. Пушкина, 67а

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 31868 - 2012 (Метод Б)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Цветность	(1 – 150) градус цветности	ГОСТ 2761 - 84 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 СанПиН 2.1.4.1175 - 02
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(1 – 150) градус цветности	
		Вода природная поверхностная	-	-		(1 – 150) градус цветности	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ПНД Ф 14.1:2.4.254 - 2009	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	(0,5 – 100) мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,5 – 100) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,5 – 100) мг/дм ³	
3	ПНД Ф 14.1:2.4.48 - 96	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация ионов меди	(0,001 – 1) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 - 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,001 – 1) мг/дм ³	
4	ПНД Ф 14.1:2.4.166 - 2000	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация алюминия	(0,04 – 0,56) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 - 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,04 – 0,56) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,04 – 0,56) мг/дм ³	
5	ГОСТ 31859 - 2012	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Химическое потребление кислорода	(10 – 50) мгО/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(10 – 50) мгО/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(10 – 50) мгО/дм ³	
6	ГОСТ 31954 - 2012 (метод А)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Жесткость	(0,1 – 10) °Ж	СанПиН 2.1.4.1074 - 01 СанПиН 2.1.4.1175 - 02
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,1 – 10) °Ж	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,1 – 10) °Ж	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ГОСТ 33045 - 2014 (метод А)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	(0,1 - 3,0) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 - 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,1 - 3,0) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,1 - 3,0) мг/дм ³	
	ГОСТ 33045 - 2014 (метод Б)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация нитритов	(0,003 - 0,3) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 - 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,003 - 0,3) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,003 - 0,3) мг/дм ³	
8	ПНД Ф 14.1.2:3-4.154 - 99	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация нитратов	(0,1 - 100) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 - 01 СанПиН 2.1.4.1175 - 02
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,1 - 100) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,1 - 100) мг/дм ³	
		Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,25 - 20) мг/дм ³	ГОСТ 2761 - 84 СанПиН 2.1.4.1074 - 01 СанПиН 2.1.4.1175 - 02
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,25 - 20) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,25 - 20) мг/дм ³	
9	ПНД Ф 14.1.2:3-4.123 - 97 (ФР.1.31.2007.03796) (Иодометрический метод)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Биохимическое потребление кислорода после 5 дней инкубации (БПК ₅)	(0,5 - 5) мгО ₂ /дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,5 - 5) мгО ₂ /дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,5 - 5) мгО ₂ /дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	ПНД Ф 14.1:2.101 - 97	Вода природная поверхностная	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0 – 15) мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00
11	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121 - 97 (ФР.1.31.2007.03794)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Водородный показатель	(5 – 9) ед. pH	СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 СанПиН 2.1.4.1175 - 02
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(5 – 9) ед. pH	
		Вода природная поверхностная	-	-		(5 – 9) ед. pH	
12	ПНД Ф 14.1:2.4.213 - 2005	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Мутность (по каолину)	(0,1 – 5) мг/дм ³	ГОСТ 2761 - 84 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 СанПиН 2.1.4.1175 - 02
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,1 – 5) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,1 – 5) мг/дм ³	
13	ПНД Ф 14.1:2.4.261 - 10	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	(1 – 200) мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 СанПиН 2.1.4.1175 - 02
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(1 – 200) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(1 – 200) мг/дм ³	
14	ГОСТ 4974 - 2014 (метод А, вариант 3)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация марганца	(0,01 – 1) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 – 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,01 – 1) мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
15	ПНД Ф 14.1:2.4.50 - 96 (ФР.1.31.2013.16018)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация общего железа	(0,05 – 5) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 – 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,05 – 5) мг/дм ³	
16	ГОСТ 31857 - 2012 (метод 3)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	(0,015–0,25) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074 – 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,015–0,25) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,015–0,25) мг/дм ³	
17	ГОСТ 31940 - 2012 (метод 3)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация сульфат - ионов	(2 – 50) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 СанПиН 2.1.4.1175 - 02
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(2 – 50) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(2 – 50) мг/дм ³	
18	ПНД Ф 14.1:2.4.112 - 97	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация фосфат - ионов	(0,05 – 5) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 – 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,05 – 5) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,05 – 5) мг/дм ³	


Лист 6 из 8

1	3	4	5	6	7	8	
19	ПНД Ф 14.1.2:4.215 - 06	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	(0,5 – 16) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 – 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,5 – 16) мг/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,5 – 16) мг/дм ³	
20	ГОСТ Р 55683 - 2013	Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-	Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора	(0,15 – 1,5) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074 - 01
21	ГОСТ 18190 - 72 (йодометрический метод)	Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-	Суммарный остаточный хлор	(0,3 – 1,5) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074 - 01
	ГОСТ 18190 - 72 (метод Пэйлина)	Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-	Свободный хлор	(0,15 – 1,5) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074 - 01
22	ГОСТ 4386 - 89 (вариант А)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Фториды	(0,05 – 0,5) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 – 01
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-			
23	РД 52.24.496 - 2005	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Запах	(0 – 5) балл	СанПиН 2.1.5.980-00
					Прозрачность	(0,1 – 40,0) см	
					Температура	(0,1 – 50,0) °С	
24	ГОСТ 4245 - 72	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Хлорид - ион	(0,5 – 100) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 СанПиН 2.1.4.1175 – 02
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,5 – 100) мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
25	ГОСТ 31957 – 2012 (метод А)	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Щелочность общая	(0,1 – 10) ммоль/дм ³	-
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-		(0,1 – 10) ммоль/дм ³	
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,1 – 10) ммоль/дм ³	
26	ГОСТ 3351 - 74	Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-	Запах (при 20°C, 60°C)	(0 – 5) балл	СанПиН 2.1.4.1074 - 01
					Привкус (вкус)	(0 – 5) балл	
27	ПНД Ф 14.1.2.105 - 97	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов	(0,002–0,03) мг/дм ³	ГН 2.1.5.1315 - 03
		Вода природная поверхностная	-	-		(0,002–0,03) мг/дм ³	
28	ГОСТ 18963-73	Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-	Бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы) БГКП (колиформы фекальные)	(0-10 ⁴) КОЕ/ 1 см ³	СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01
29	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	(0-300) КОЕ/ 1 см ³	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02
			-	-	Общие колиформные бактерии	(0-10 ⁴) КОЕ/ 1 см ³	
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	(0-10 ⁴) КОЕ/ 1 см ³	
			-	-	Колифаги	(0; 0,1-113,9) БОЕ/ 100 см ³	
			-	-	Споры сульфитредуцирующих клуберидий	(0-10 ⁴) КОЕ/ 20 см ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
30	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	(0-10 ⁴) КОЕ/ 1 см ³	СанПиН 2.1.5.980-00
			-	-	Общие колиформные бактерии	(0-10 ⁴) КОЕ/ 1 см ³	
			-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	(0-10 ⁴) КОЕ/ 1 см ³	
			-	-	Колифаги	(0-10 ⁴) БОЕ/ 100см ³	
			-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	(0-10 ⁴) КОЕ/ 20 см ³	
31	ГОСТ 31861 - 2012	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Отбор проб	-	-
32	ГОСТ 31942 - 2012	Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Отбор проб	-	-
		Вода питьевая централизованного, нецентрализованного водоснабжения	-	-	Отбор проб	-	-
		Вода природная поверхностная	-	-	Отбор проб	-	-

Директор ООО «Водоканал – НТ»

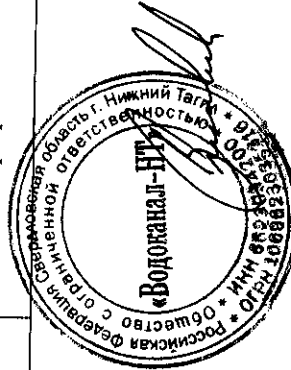

В.В. Таран