



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от «18» ноября 2019 г.

№ АА-504

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.РЦ.312833

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЕДСЕРВИС» (ООО «ПРОМЕДСЕРВИС»)

наименование юридического лица или фамилия, имя отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

625018, РОССИЯ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, дом 132, строение 12, офис 1

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Спирометры, спирографы, спироанализаторы, пневмотахометры, аппараты и каналы для измерения объемного расхода	(0 – 8) дм ³ (0 – 18) дм ³ /с	ПГ ±3 % ПГ ±3 %	
Измерения давления, вакуумные измерения				
2	Измерители артериального давления автоматические и полуавтоматические, приборы суточного мониторирования, сфигмоманометры	(0 – 300) мм рт.ст. (30 – 200) мин ⁻¹	ПГ ±2 мм рт. ст. ПГ ±5 %	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
3	Анализаторы состава биологических проб	(0 – 4) Б WBC (0,1 – 100) · 10 ⁹ 1/л RBC (0,1 – 10) · 10 ¹² 1/л HGB (6 – 300) г/л Белок (0,3 – 5) г/л	ПГ ±(0,01 – 0,07) Б ПГ ±(10 – 15) % ПГ ±(10 – 15) % ПГ ±(10 – 15) % ПГ ±(10 – 20) %	

		Плотность (1,000 – 1,040) г/мл pH (4,5 – 9,0) pH RBC/HGB (10 – 300) клет/мкл Глюкоза (0,1 – 56,0) ммоль/л Лактат (0,1 – 40,0) ммоль/л Мочевина (0,1 – 40,0) ммоль/л Холестерин (0,1 – 20,0) ммоль/л Na ⁺ (20 – 200) ммоль/л K ⁺ (0,2 – 200) ммоль/л Ca ⁺ (0,1 – 6,0) ммоль/л Cl ⁻ (15 – 200) ммоль/л Li ⁺ (0,2 – 5,0) ммоль/л Тестостерон (1 – 77) нмоль/л	ПГ ±(10 – 20) % ПГ ±(0,15 – 0,5) pH ПГ ±(15 – 20) % ПГ ±(7 – 20) % СКО ±3% ПГ ±(7 – 20) % СКО ±3% ПГ ±(15 – 20) % ПГ ±(10 – 20) % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±25 %	
4	Гемоглобинометры	(0 – 360) г/л (0 – 0,999) Б	ПГ ±4 % ПГ ±0,01 Б СКО ±0,01 Б	
5	Коагулометры, анализаторы показателей гемостаза	(0 – 1800) с	ПГ ±(1 – 3) с	
Теплофизические и температурные измерения				
6	Термометры медицинские контактные	(32 – 44) °C	ПГ ±0,1 °C	
Радиотехнические и радиоэлектронные измерения				
7	Электрокардиографы, электрокардиоанализато ры, измерительные каналы ЭКГ, приборы суточного мониторирования	(0,03 – 10) мВ (0,1 – 10) с (30 – 240) мин ⁻¹	ПГ ±(3 – 15) % ПГ ±5 % ПГ ±2 мин ⁻¹	
8	Реографы, реоплетизмографы, реообразователи, реоанализаторы	(10 – 1000) Ом	ПГ ±(6 – 15) %	
9	Электромиографические приборы	(0,02 – 0,1) мВ (0,1 – 150) мВ	ПГ ±15 % ПГ ±5 %	

10	Пульсоксиметры и каналы мониторов пульсоксиметрические	(70 – 80) % (81 – 100) % (25 – 250) мин ⁻¹	ПГ ±3 % ПГ ±2 % ПГ ±3 мин ⁻¹	
Оптические и оптико-физические измерения				
11	Анализаторы иммуноферментные, фотометры микропланшетные	340-750 нм (0 – 0,4) Б (0,4 – 4) Б	ПГ ±0,02 Б ПГ ± (2 – 5) %	
12	Линейки скиаскопические	[(-20) – (+20)] дптр	ПГ ± (0,12 – 4) дптр	


Генеральный директор
должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

А.А.Шестаков
инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
2 (две) листа (ов)

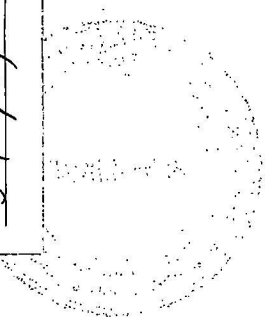

В.Д. Пономаренко

Эксперт по аккредитации:

Технические эксперты:

А.В. Квацев

А.В. Солнцев

Д.С. Клишневич

Л.В. Юров

Левченко