


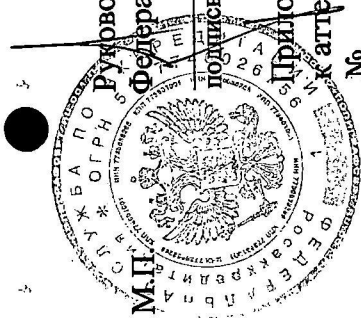

М.П. Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

02 ОКТ 2019

Приложение

к аттестату об аккредитации

№

от « » 20 г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации

испытательной лаборатории (центра) ООО «Гамма»

наименование испытательной лаборатории юридического лица

153012, г. Иваново, ул. Советская, д.22, лит.В, оф. 303

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7.3	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне 30 кГц – 300 МГц	(0,5-300) В/м
2	МУК 4.3.1677-03 п.3.3.2	Места размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне 300 МГц – 40 ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
3	МУК 4.3.1677-03 п.3.3.3	Места размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне 27 МГц – 300 МГц	(0,5-300) В/м
4	МУК 4.3.1677-03 п.3.3.4	Места размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне 300 МГц – 2400 МГц	(0,26-100000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
5	МУК 4.3.2756-10 п.4	Производственные помещения Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-40...+85) °C
6	МУК 4.3.2756-10 п.5	Производственные помещения Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	(3-97) %
7	ГОСТ 30494-2011 п. 6	Здания жилые и общественные	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
8	ГОСТ 24940-2016 п.5	Помещения зданий и сооружений, ра- бочие места	-	-	Температура воздуха	(-40...+85) °C
9	ГОСТ 24940-2016 п.6	Помещения зданий и сооружений, ра- бочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	(3-97) %
10	МУК 4.3.2194-07 п. 2	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
11	МУК 4.3.2194-07 п. 3	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения	-	-	Результатирующая температура	(+0...+85) °C
					Освещенность от искусст- венного освещения	(10-200000) лк
					Освещенность от искусст- венного освещения	(10-200000) лк
					Уровни звукового давле- ния в октавных полосах частот	(24 - 137) дБ
					Уровни звука и эквива- лентные уровни звука	(24-137) дБА
					Максимальные уровни звука	(24-137) дБА
					Уровни звукового давле- ния в октавных полосах частот	(24 - 137) дБ
					Уровни звука и эквива- лентные уровни звука	(24-137) дБА
					Максимальные уровни зву- ка	(24-137) дБА

1	2	3	4	5	6	7
12	МУ 2.6.1.2398-08 п. 4	Земельные участки, отводимые под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10-1000) мкЗв/ч
13	МУ 2.6.1.2398-08 п. 5	Земельные участки, отводимые под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10-1000) мкЗв/ч
14	МУ 2.6.1.2398-08 п. 4	Земельные участки, отводимые под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Плотность потока радона (ППР)	(20-10 ³) мБк/с×м ²
15	МУ 2.6.1.2398-08 п. 6	Земельные участки, отводимые под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Плотность потока радона (ППР)	(20-10 ³) мБк/с×м ²
16	МУ 2.6.1.2838-11 п. 5	Помещения зданий	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,05-50) мкЗв/ч (0,10-1000) мкЗв/ч
17	МУ 2.6.1.2838-11 п. 6	Воздух помещений	-	-	Среднегодовое значение эквивалентной равновесной активности (ЭРОА) радона	-
					Среднегодовое значение эквивалентной равновесной активности (ЭРОА) торона	-
18	Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «Альфарад плюс» Руководство по эксплуатации БВЕК 590000.001 РЭ	Воздух жилых и рабочих помещений	-	-	Эквивалентная равновесная активности (ЭРОА) радона	(1,0-1,0×10 ⁶) Бк/м ³
19	Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «Альфарад плюс» Руководство по эксплуатации БВЕК 590000.001 РЭ	Поверхность грунта	-	-	Эквивалентная равновесная активности (ЭРОА) торона	(0,5-1,0×10 ⁴) Бк/м ³
					Плотность потока радона (ППР)	(20-103) мБк/с×м ²




Руководитель испытательной лаборатории ООО «Гамма»

В.А. Привалова

Генеральный директор ООО «Гамма»

Н.В. Привалов

на 3 листах



Андросова О. В.

Гращенко Т. А.