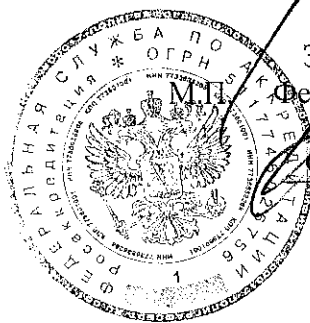


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

СЕМИСОРОВА К. Н.

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от « » 20 г.

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Публичное акционерное общество «Мстатор» (ПАО «Мстатор»)

(наименование юридического лица)

174400, г. Боровичи, ул. А. Невского, 10

(адрес места осуществления деятельности)

Поверка средств измерений

(шифр поверительного клейма)

№	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения электротехнических и магнитных величин				
1	Измерители индуктивности	1 мкГн – 100 мГн 1 кГц – 1 МГц	$ПГ \pm (0,01 Lx + 1,5K)$ мкГн	
2	Измерители емкости	(26 – 1000) пФ (300 – 700) кГц	$ПГ \pm (0,005 Cx + 0,4)$ пФ	
3	Измерители добротности	(25 – 75) ед. (0,05 – 1) МГц	$ПГ \pm (3 + Q_k / Q_{изм})\%$ $ПГ \pm 1\%$	
4	Измерители электрического сопротивления (омметры)	(0,01 – 10^9) Ом	$ПГ \pm 2,5\%$	
5	Измерители электрического тока	(50 – 500) мА	$ПГ \pm 0,5\%$	
Радиотехнические и радиоэлектронные измерения				
6	Генераторы низкочастотные	20 Гц – 1 МГц 10 мВ – 60 В	$ПГ \pm (3 + 30/F)\%$ $ПГ \pm (5 - 10)\%$ $K_r \leq 0,1\%$	
7	Генераторы импульсов	10 нс – 10 мкс 6 мВ – 100 В	$ПГ \pm (10\% + 0,03)$ мкс $ПГ \pm 5\%$	
8	Вольтметры электронные переменного тока	100 мВ – 300 В 10 Гц – 50 МГц	$ПГ \pm (2,5 - 4)\%$	

1	2	3	4	5
9	Осциллографы электронно-лучевые универсальные	10 нс/д – 0,5 с/д 10 мВ/д – 10 В/д (0 – 50) МГц	ПГ± (3 – 10) % ПГ± (3 – 10) %	



Генеральный директор

Н.В.Даньшин

Руководитель экспертной группы



О.К. Борисова

Члены экспертной группы



А.Ю. Кондратьев



С.Е. Иванов

В данном документе
прошито и пронумеровано

2

листа

