


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

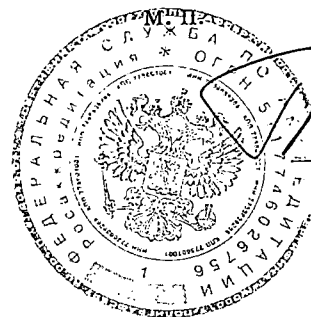

ЛИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

25 АПР 2018

Приложение к аттестату аккредитации


№ _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

на 3 листах, лист 1

**Область аккредитации углехимической лаборатории
отделения в г. Новокузнецке Кемеровского филиала АО «Инспекторат Р» в г. Белово
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ш. Космическое д.16, корп. 335**


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 52911	Каменные угли, бурые угли, антрациты	05.1 05.2	2701 12 100 0 2701 19 000 0 2702 10 000 0 2701 11 100 0	Массовая доля общей влаги, высушиванием пробы с крупностью кусков не более 3 мм на воздухе, %	(0,1-40)
2	ГОСТ Р 33503				Массовая доля аналитической влаги, высушиванием на воздухе %	(0,1-8,0)
3	ГОСТ 1186	Каменные угли	05.1	2701 12 100 0 2701 19 000 0 2701 11 100 0	Пластометрическая усадка, мм	от минус 15 до 60
					Толщина пластического слоя, мм	(0-50)



1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 55661	Каменные угли, бурые угли, антрациты, кокс	05.1 05.2 19.1	2701 12 100 0	Зольность, %	(0,1-90,0)
				2701 19 000 0		
				2702 10 000 0		
5	ГОСТ Р 55660			2701 11 100 0	Выход летучих веществ, %	(0,1-90,0)
				2708 20 000 1		
				2708 20 000 9		
				2708 10 000 0	Теплота сгорания высшая, ккал/кг	(3000-10000)
				2704 00 110 0		
				2704 00 190 0		
6	ГОСТ 147			2704 00 300 0	Низшая теплота сгорания, расчетная, ккал/кг	(500-9000)
				2704 00 900 0		
				2713 11 000 0		
				2713 12 000 1		
				2713 12 000 9		
7	ГОСТ 32465	Каменные угли, бурые угли, антрациты, кокс	05.1 05.2 19.1	2701 12 100 0 2701 19 000 0 2702 10 000 0 2701 11 100 0 2708 20 000 1 2708 20 000 9 2708 10 000 0 2704 00 110 0 2704 00 190 0 2704 00 300 0 2704 00 900 0 2713 11 000 0 2713 12 000 1 2713 12 000 9	Массовая доля общей серы, %	(0,1-9,0)
8	ГОСТ Р 55659	Каменные угли	05.1	2701 12 100 0 2701 19 000 0 2702 10 000 0 2701 11 100 0	Показатель отражения витринита, %	(0,5-2,0)

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ Р 55662	Каменные угли	05.1	2701 12 100 0	Липтинит, %	(0-90)
				2701 19 000 0	Витринит, %	(10-100)
				2702 10 000 0	Семивитринит, %	(0-50)
				2701 11 100 0	Инертинит, %	(0-90)
					Минеральные вещества, %	(0-50)
10	ГОСТ 8930	Каменные угли	05.1	2701 12 100 0 2701 19 000 0 2702 10 000 0 2701 11 100 0	Окисленность, %	(0-100)
11	ГОСТ Р 32979	Каменные угли, бурые угли, антрациты, кокс	05.1 05.2 19.1	2701 12 100 0 2701 19 000 0 2702 10 000 0 2701 11 100 0	Массовая доля углерода, %	(10-95)
				2708 20 000 1 2708 20 000 9 2708 10 000 0	Массовая доля водорода, %	(0,1-20)
				2704 00 110 0 2704 00 190 0	Массовая доля азота, %	(0,1-20)
				2708 20 000 1 2708 20 000 9	Массовая доля общей влаги, %	(0,1-50)
				2708 10 000 0 2704 00 110 0 2704 00 190 0 2704 00 300 0 2704 00 900 0 2713 11 000 0 2713 12 000 1 2713 12 000 9	Массовая доля влаги в аналитической пробе, %	(0,1-8,0)
12	ГОСТ 27588	Кокс	19.1			
13	ГОСТ 27589					

Директор Кемеровского филиала АО «Инспекторат Р» в г. Белово

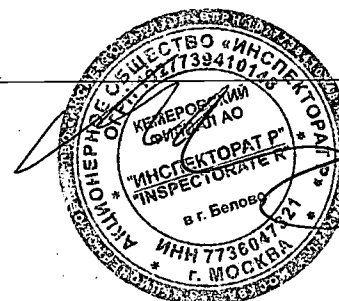

Ю.А. Магарин


Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

3 листа

три листа

Заведующая УИЛ Гавриленко М.В.

Подпись



Руководитель экспертной группы

Технический эксперт

Чигвинцева
Ботова

К.А. Чигвинцева

Е.П. Ботова

Аку

Ботова