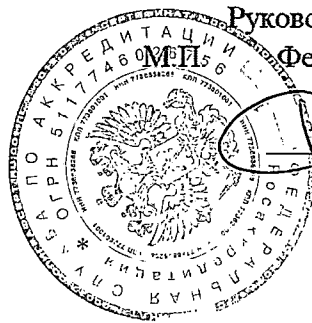


ЭКЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИПриложение  
к аттестату аккредитации

№ \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

на 1 листе, лист 1

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Дагестанский Центр Экспертизы и Метрологии  
«МЕТРО-ТЕСТ» (ООО ДЦЭиМ «МЕТРО-ТЕСТ»)

(наименование юридического лица)

367009 Россия, г. Махачкала, ул. Керимова, дом 7

(адрес места осуществления деятельности)

Поверка средств измерений

(цифр поверительного клейма)

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность измерений (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
<b>Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ</b>				
1	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические	(100 – 3 000) м <sup>3</sup> (3 000 – 5 000) м <sup>3</sup> (5 000 – 10 000 и более) м <sup>3</sup>	ПГ ± 0,2 % ПГ ± 0,15 ПГ ± 0,1 %	
2	Колонки топливораздаточные	(33·10 <sup>-6</sup> – 42·10 <sup>-4</sup> ) м <sup>3</sup> /с	ПГ ± (0,25 – 1) %	
3	Мерники	(2 – 50) дм <sup>3</sup>	ПГ ± 0,2 %	
4	Комплексы измерительные микропроцессорные (для вычисления значений объема и расхода газа)	Перепад давления (2,5 – 250,0) кПа Избыточное давление (0,1 – 6,0) МПа	ПГ ± 0,1 % ПГ ± 0,1 %	
<b>Измерения давления, вакуумные измерения</b>				
5	Манометры	(0 – 6) МПа	КТ (0,25 – 4)	



 М.М. Мургазалиев

Эксперт по аккредитации

*Л.Ш. Хафизова*

Л.Ш. Хафизова

Технические эксперты

*А.Ю. Кондратьев*

А.Ю. Кондратьев

*Р.М. Галимарданов*

Р.М. Галимарданов

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

